

中药煎药机询价采购公告（二次）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《四川省政府集中采购目录及标准》等法律法规，我单位诚邀符合条件的申请人参加“开江县中医院中药煎药机采购项目（二次）”，欢迎符合条件的各潜在供应商前来响应。实施方式：询价采购方式。如有意参与本次询价，请及时办理询价手续并领取相关资料，并在本邀请规定的时间内提交相关资料。

一、项目概况

项目名称：开江县中医院中药煎药机采购项目（二次）。

项目预算：5.5 万元人民币（伍万伍仟元整）。

二、拟采购产品清单

设备名称	数量	单位	备注	技术要求
中药煎药机	1	台	密闭 3+1+打包	见附件
中药煎药机	1	台	常压 3+1 双煎+打包	见附件

三、申请人须递交的响应文件

- 1、供应商营业执照、开户许可证等；
- 2、行业产品应包含的资质文件；
- 3、授权委托书（包含授权期限、联系电话）、被授权人身份证复印件（有工作人员到现场或有非法人签订的相应文件才需提供）；
- 4、产品技术参数文件等资料；

5、产品报价单包括：产品名称、厂家、品牌、规格型号、单价、质保期。

★所有资质证件复印件及报价单须加盖经营企业公章。

★所有资料密封保存，材料外包装应保证其密封性，在密封的骑缝处加盖招标申请人单位公章。未按要求密封的申请书将不予受理。

★资料不全、资质证明弄虚作假，将取消该申请人在我院的投标资格。

四、询价采购报名及相应文件递交时间及地点：

申请人于截止时间前，将资料密封后于医院现场递交或者邮寄至开江县中医院，逾期将被拒绝。

报名开始时间：2024年9月9日8点。

报名截止时间：2024年9月12日12点。

收件人姓名：孙国金；

收件人电话：13890422577；

地址：四川省达州市开江县新宁镇淙城后街153号

五、资格审查方式：资格后审

六、询价原则、结果确定时间及方法

询价资料审核时间：2024年9月12日。本次询价在符合产品参数要求的情况下，采用最低价法，确定一家申请人为中选人，并向中选人发出中选通知书并在医院官网进行公示。若中选人放弃中选、或提出书面说明不能履行合同的，



采购人将依次从候选人中补齐中选人。如果出现并列的情况，采购人有权自行从中确定中选人，其他申请人不得有异议。


七、中选结果公示：中选结果将在医院官网进行公示。

5/2

技术参数及特点描述

密闭三连体煎药机+中药汤剂包装组合机

- 1、型号：密闭三连体煎药机+中药汤剂包装组合机
- 2、容量：20000ML×3+20000ML
- 3、功率：6000W+800W +800W
- 4、电压：AC220V
- 5、*采用一键式滑盖锁紧技术，配滑键锁扣实现双重保险，安全可靠、操作简便。
- 6、3个煎药锅体，每次可同时煎煮3个处方。
- 7、密闭煎煮，避免挥发。
- 8、机械挤压装置，充分提取残留药汁。
- 9、武火、文火自动转换。
- 10、能够设置煎药时间或煎药完毕自动提示。
- 11、*具有安全卸压阀，双安全阀超压自动报警，自动卸压自动闭合。
- 12、数字显示温度。
- 13、可与包装机通过金属软管组合，美观大方。
- 14、采用数控技术，操作简洁。
- 15、配单体包装机，包装量 50-250ml 以每 1ml 为变量，无级任意可调。
- 16、包装速度：7 袋/分钟。
- 17、通过 ISO9001 质量认证。

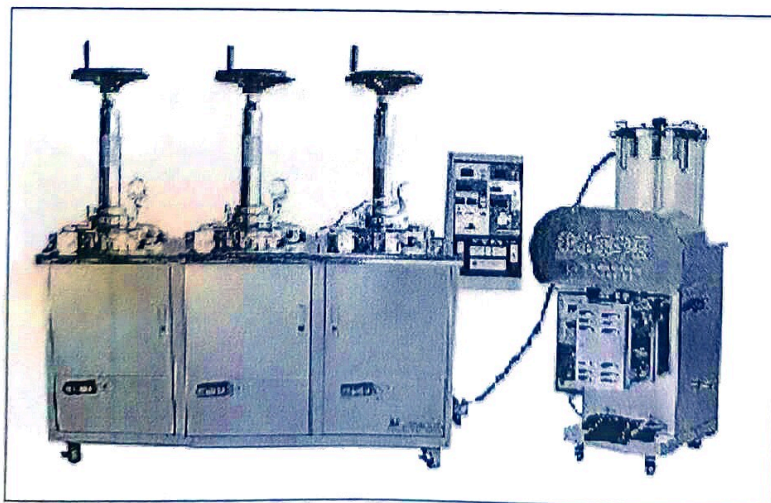


2024.9.2

技术参数及特点描述

常压 3+1 两煎煎药包装一体机

- 1、型号：常压 3+1 两煎煎药包装一体机
- 2、容量：20000mlX3
- 3、功率：7000W
- 4、电压：AC220V
- 5、煎药包装一体组合，结构紧凑合理，美观大方，节省空间；
- 6、*以特制储药筒储存两次煎煮的药液，自动实现常压两煎全过程；
- 7、遵循古法，设定时间，蜂鸣提示，简易实现先煎、后下；
- 8、煎煮时筒内外产生压力差，形成水流循环搅拌作用，更均匀；
- 9、文火、武火自动转换，契合传统煎药慢火，紧火之法，保证药效；
- 10、玻璃筒体，煎药过程清晰可见，可自动清洗，保证煎煮过程卫生；
- 11、防干烧功能，当温度过高或无水时，系统停止加热并蜂鸣报警；
- 12、整体煎药包装过程采用精密数控技术，控制精度高；
- 13、*50-250ml 以每 1ml 为变量范围，无极可调包装，满足不同顾客需求；
- 14、具有先进的包装量科学校准功能；
- 15、包装速度：8 袋/分钟；
- 16、*售后服务有保障，在全国各省内均设有注册售后服务机构，提供本地化服务。

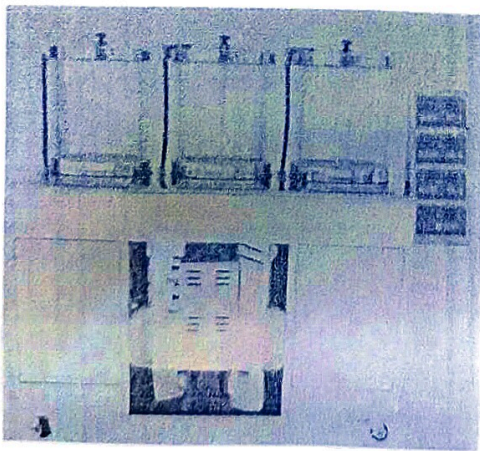

2024

2024. P. 2